

# PEELVUE<sup>+</sup>

## STERILISIERUNGSBEUTEL

Trust.Worthy.Innovation.



## PeelVue+. Weil Sicherheit nicht Selbstverständlich ist. Jetzt mit Schließ-Validatoren!

### Sicher

Äußere und **patentierte innere Indikatoren** sind direkt in die Steriltüten "eingebaut".

Ventile auf beiden Seiten des inneren Indikators belüften das System und sorgen für **gleiche Bedingungen innerhalb und außerhalb der Steriltüten.**


**10 mm** breite, absolut dichte, sichere Klebnaht.

**Schließ-Validatoren** (Dreiecke) markieren die genaue Klebposition zum Schließen des Beutels.

### Bequem

Die vorversiegelte Seite der Steriltüte mit ihren nicht verklebten Ecken erlaubt ein **leichtes Öffnen der Tüte**, sogar mit Handschuhen.

Das Klebeband mit einer **19 mm breiten selbstklebenden Klebnaht** macht ein Schweißgerät überflüssig.

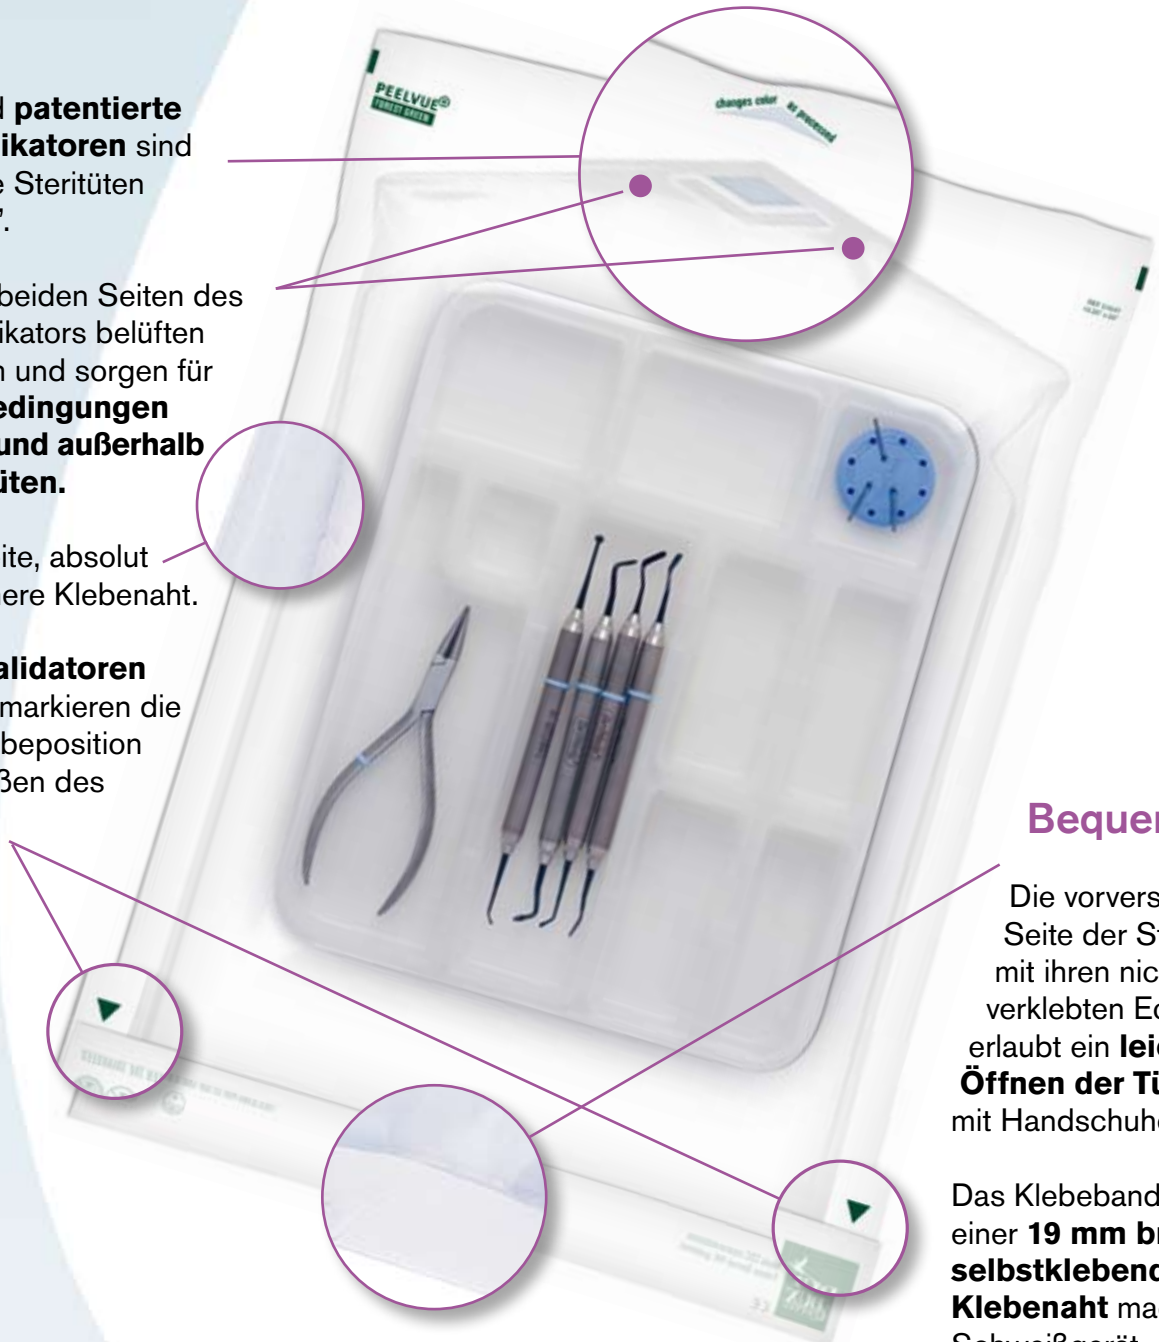

*Sicher, bequem, kostengünstig, einfach in der Anwendung.*

## Verschiedene Beutelgrößen für alle vorkommenden Anwendungen

Peel-Vue+ Steribeutel sind einfach zu verkleben und einfach zu öffnen. Sie besitzen einen patentierten internen Indikator (IPI), sie sind beschriftet mit bleifreier, ungiftiger Tinte, gefertigt aus medizinisch geprüftem Papier. Wenn Sie den klaren Teil des Beutels abziehen, können Sie den Papieranteil als sterilisierte Unterlage benutzen.



Best. Nr.	Beschreibung	Größe	Farbe	Menge
31610	Implantate, Kofferdam Klammern	90 x 135 mm		200
31611	Hand- und Winkelstücke, Handinstrumente	 70 x 230 mm		200
31612	Hand- und Winkelstücke, Handinstrumente	90 x 230 mm		200
31613	Implantate, Bohrer, Scalertips	55 x 100 mm		200
31614	Abdrucklöffel, Bohrerständer	 135 x 165 mm		200
31615	Mehrere Instrumente und Cassetten	 215 x 380 mm		200
31616	Handinstrumente (lang)	 85 x 305 mm		200
31617	Chirurgie, Kieferorthopädie	110 x 305 mm		200
31618	Mehrere Instrumente und kleine Cassetten	205 x 305 mm		200
31619	Mehrere Instrumente	 135 x 305 mm		200
31643	Große Cassetten	265 x 405 mm		200
31647	Große Cassetten (I.M.S.)	335 x 510 mm		200

Jetzt mit Schließ-Validatoren!



Der neue QMS-Leitfaden für PeelVue+ Sterilisationsbeutel. Jetzt zum Herunterladen auf: [www.dux-dental.com](http://www.dux-dental.com)

PeelVue+ Sterilisationsbeutel entsprechen der Direktive 93/42 EEC, DIN EN 868-5, ISO 11607 und erfüllen die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, US CDC und ADA.